医療用・介護用吸水ラミシーツ

Powered by KINSEI ～Since 1917～

マルチラミシーツ

天然原料由来の
再生繊維
レーヨン100%
不織布

保湿


消臭

抗菌

抗ウイルス

ソフト

レーヨン
100%

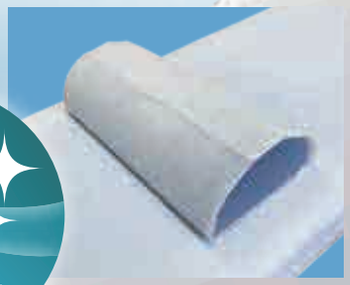





規　格			
商品名	形状	サイズ	吸水量（g/m²）
マルチラミシーツ	折りたたみタイプ	100cm ×120cm	185g/m²
		100cm ×180cm	
マルチラミシーツ R	ロールタイプ	30cm × 37cm ミシン目ロール 120枚セット	
		80cm × 50 m	
		100cm × 50 m	

医療用・介護用吸水ラミシーツ


マルチラミシーツ

保湿　消臭　抗菌　ソフト　レーヨン100%　抗ウイルス


消臭 試験データ

アンモニア臭・
汗臭の原因物質を
減少させる
効果あり。


減少率＝70%以上で合格（検知管法）

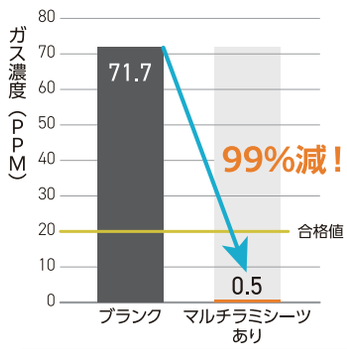

減少率＝70%以上で合格（検知管法）

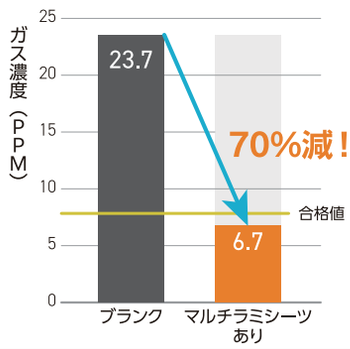

減少率＝A85%以上で合格（ガスクロマトグラフ法）

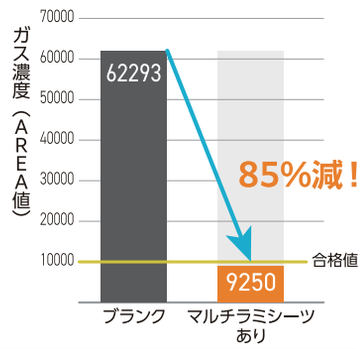


■測定法：SEKマーク繊維製品認証に基づく方法　■試料：アンモニア酢酸100cm²・イソ吉草酸50cm²　規定量の臭気強度2.0ガスを充てん

抗ウイルス 試験データ

菌だけでなく
インフルエンザ
ウイルスにも
効果を確認

ウイルス感染価比較（対数値）

試料	ウイルス感染価（PFU/vial）常用対数平均値		抗ウイルス活性値（Mv）（合格基準値：≧3.0）
標準布	接種直後	6.70	
	2時間作用後	6.25	
マルチラミシーツ	2時間作用後	**2.30**	**4.4**

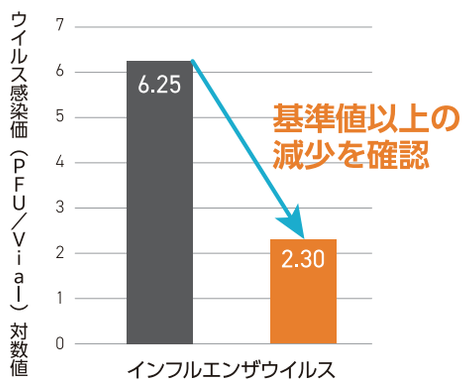


■試験法：JISL1922繊維製品の抗ウイルス性試験方法（ISO18184 ）　■試験ウイルス株：ATCCVR-1679　■宿主細胞：MDCK細胞

抗菌 試験データ

院内感染の原因
とされる菌に
効果あり。

抗菌活性効果値比較

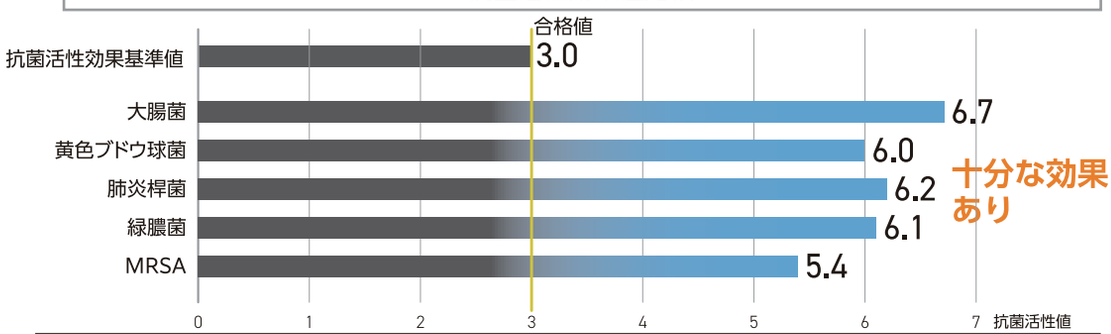

■測定法：JISL1902繊維製品の抗菌性試験・定量試験（菌液吸収法）
■大腸菌株：Escherichia coliNBRC3080　■黄色ブドウ球菌：Staphylococcus aureusNBRC12732
■緑膿菌：Pseudomonas aeruginosaNBRC3080　■肺炎桿菌：KlebsiellapneumoniaeNBRC13277

■測定機関：大和化学工業評価技術センター

ご使用上の注意

- ●消臭・抗菌・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ●抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。
- ●すべての菌やウイルスに対しての効果を保証するものではありません。
- ●肌に合わないと感じた場合は速やかにご使用をお控えください。
- ●各データは測定値であり、保証値ではありません。

製造元：金星製紙株式会社

お問合せ先
トレンドサイン株式会社
https://www.trendsign.co.jp
〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング二号館 10F
TEL：03-5937-5721　FAX：03-5937-5722